

# 《ネリプロクト®坐剤 温度と開封時の注意に關しまして》

## ❗ 温度に關する注意


- あまり暑くならない場所(1°C~30°C)で保管してください。  
(この薬は体温で溶けるため)
- 冷凍庫(0°C以下)での保管は避けてください。  
(坐剤のひび割れを生じる場合があるため)
- 冷蔵庫に保管されている場合は冷蔵庫から取り出して  
20~30分後に使用してください。

1°C ~ 30°C

~~0°C以下~~


## ❗ 開封時の注意

- アルミ箔で手を切らないように  
注意して薬を取り出して下さい。

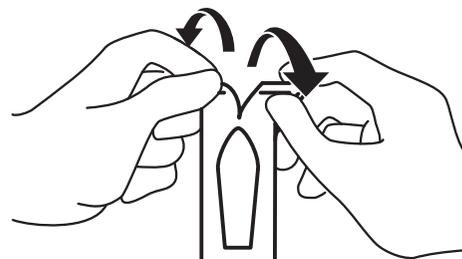


## 《ネリプロクト®坐剤の使い方》

### 手順 1

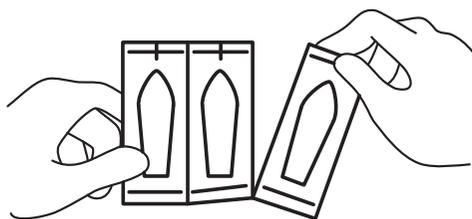


アルミ箔の切れ目から、1個分を切り離して下さい。

### 手順 2

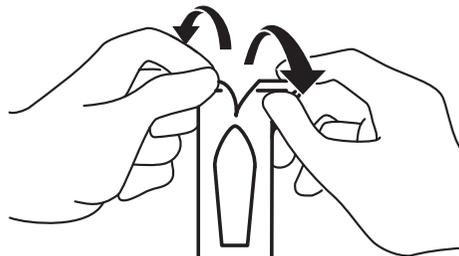

切り込み部からゆっくり前後に開いて、坐剤を取り出して下さい。

### 手順 3

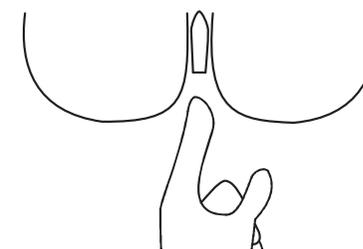

先のとがった方を肛門内にさし込み、奥まで入れてしばらくおさえて下さい。



この薬は体温で溶けますのであまり暑くない場所(1℃～30℃)で保管して下さい。  
アルミ箔で手を切らないように注意して薬を取り出して下さい。

### 使用上の注意

- 医師の指示に従い、使い方をよく守ってご使用下さい。
- この薬は飲まないで下さい。

### 取扱い上の注意

- お子様が誤って使用しないよう、お子様の手の届かない所に保管して下さい。
- 坐剤のひび割れを生じる場合がありますので冷凍庫(0℃以下)での保管は避けて下さい。
- 冷蔵庫に保管されている場合は冷蔵庫から取り出して20～30分後に使用して下さい。
- 薬の先端(とがった方)を下にして立てて保管して下さい。

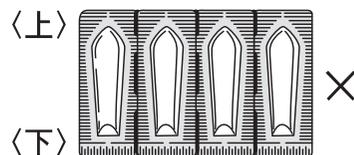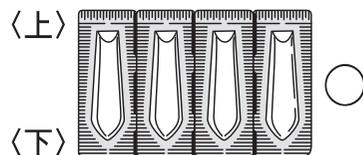

レオファーマ株式会社 LTLファーマ株式会社

MAT-42558  
2021年2月作成